

## **Первичная специализированная аккредитация специалистов здравоохранения**

# **Паспорт экзаменационной станции (типовой)**

# **Врачебные манипуляции**

## **(Проведение инфузионной терапии через подкожный порт)**

## **Специальность:**

## **Онкология**

**2019**

## **Оглавление**

1. Авторы.....	3
2. Уровень измеряемой подготовки.....	3
3. Профессиональный стандарт (трудовые функции) .....	3
4. Проверяемые компетенции .....	3
5. Продолжительность работы станции .....	3
6. Задачи станции .....	4
7. Информация по обеспечению работы станции .....	4
7.1. Рабочее место члена АК .....	4
7.2. Рабочее место аккредитуемого .....	4
7.3. Расходные материалы .....	6
7.4. Симуляционное оборудование .....	6
8. Перечень ситуаций (сценариев) станции .....	7
9. Информация (брифинг) для аккредитуемого .....	7
10. Информация для членов АК .....	7
10.1. Действия вспомогательного персонала перед началом работы станции .....	7
10.2. Действия вспомогательного персонала в ходе работы станции .....	8
10.3. Действия членов АК перед началом работы станции .....	8
10.4. Действия членов АК в ходе работы станции .....	8
11. Нормативные и методические документы, используемые для создания паспорта станции .....	9
11.1. Справочная информация.....	10
12. Информация для симулированного пациента .....	11
13. Информация для симулированного коллеги.....	11
14. Критерии оценивания действий аккредитуемого.....	11
15. Дефектная ведомость .....	13
16. Оценочный лист (чек-лист) .....	14
16.1. Краткая версия чек-листа.....	14
16.2. Развёрнутая версия чек-листа.....	16
17. Медицинская документация.....	30

**1. Авторы**

Воздвиженская А.В., Грибков Д.М., Золотова Е.Н., Киселева А.Э., Косцова Н.Г., Ольховик Н.Г., Тогоев О.О., Фатьянова А.С., Царенко О.И., Шубина Л.Б.

**Общие положения.** Паспорта станций (далее станции) объективного структурированного клинического экзамена (ОСКЭ) представляют собой документ, включающий необходимую информацию по оснащению станции, брифинг (краткое задание перед входом на станцию), сценарии, оценочные листы (далее – чек-лист), источники информации, справочный материал и т.д., предназначены в качестве методического и справочного материала для оценки владения аккредитуемым конкретной КОМПЕТЕНЦИЕЙ и могут быть использованы для оценки уровня практической готовности специалистов здравоохранения к практической деятельности, в трудовые функции которых входит владение данной компетенцией.

Оценивание особенностей практических навыков конкретной специальности могут быть реализованы через выбор конкретных сценариев; решение принимает аккредитационная комиссия по специальности (далее – АК) непосредственно во время проведения экзамена. С целью обеспечения статистической стандартизации процедуры оценки практических навыков условия задания и чек-лист являются едиными для всех.

Целесообразно заранее объявить аккредитуемым о необходимости приходить на второй этап в спецодежде (медицинская одежда, сменная обувь, шапочка), иметь личный стетофонендоскоп и перчатки нужного ему размера в достаточном количестве.

**2. Уровень измеряемой подготовки**

Готовность выполнения практического навыка врачом по специальности «Онкология»

**3. Профессиональный стандарт (трудовые функции)**

A/03.8 Назначение и проведение лечения пациентам с онкологическими заболеваниями, контроль его эффективности и безопасности

**4. Проверяемые компетенции**

Выполнение медицинских манипуляций: введение лекарственных препаратов через имплантированный подкожный венозный порт

**5. Продолжительность работы станции**

**Всего – 10' (на непосредственную работу – 8,5')**

0,5' – ознакомление с заданием (брифинг)	0,5'
7,5' – предупреждение об оставшемся времени на выполнение задания	8'
1' – приглашение перейти на следующую станцию	9'

1' – смена аккредитуемых

10'

## **6. Задачи станции**

Демонстрация аккредитуемым своего умения проводить манипуляцию, обеспечивая безопасность проведения процедуры.

*Примечание: оценка навыков разведения ЛС, сборка инфузионной системы, гигиенической обработки рук, общения с «трудным» пациентом не проводится.*

## **7. Информация по обеспечению работы станции**

Для организации работы станции должны быть предусмотрены

### **7.1. Рабочее место члена АК**

1. Стол и рабочая поверхность (стол).
2. Компьютер с выходом в Интернет для доступа к автоматизированной системе аккредитации специалистов здравоохранения.
3. Устройство для трансляции видео и аудио изображения<sup>1</sup> с места работы аккредитуемого с возможностью давать вводные, предусмотренные паспортом станции.

### **7.2. Рабочее место аккредитуемого**

Станция должна имитировать **медицинский (процедурный) кабинет поликлиники и включать оборудование (оснащение)<sup>2</sup>**

1. Место (перед входом в помещение) для размещения задания аккредитуемому (раздел 7).
2. Стол для записей<sup>3</sup>.
3. В пластиковом кармане страница Листа назначений (раздел 17).
4. Стол с установленным на него симуляционным оборудованием, имитирующий место выполнения манипуляции.
5. Аптечка Анти-Вич и укладка экстренной медицинской помощи (достаточно имитации в виде фото).
6. Раковина и средства для обработки рук, (или их имитация) приспособления для высушивания рук<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> По согласованию с председателем АК устройство с трансляцией видеозаписи изображения работы аккредитуемого может находиться в другом месте, к которому члены АК должны иметь беспрепятственный доступ, чтобы иметь возможность пересмотреть видеозапись

<sup>2</sup> Перечень обязательного оснащения кабинета (станции) не отражает перечень оснащения реального кабинета, а содержит только тот минимум, который необходим для решения конкретной задачи данной экзаменационной станции. По усмотрению организаторов кабинет может быть дополнительно оснащен в соответствии с нормативной базой, но не создавал при этом помех для основной цели работы на станции

<sup>3</sup> Целесообразно всё, что может быть случайно унесено аккредитуемым (пластиковый лист назначений, маркер и т.п.), закрепить к столу для записей

7. Тележка (шкаф), с размещенным необходимым материалом для выполнения манипуляции, имитирующий условия их хранения<sup>5</sup>.
  8. Штатив для крепления инфузионной системы.
  9. Закреплённая на штативе, собранная инфузионная система с флаконом, имитирующим флакон с ЛС для химиотерапии.
  10. Пустые флаконы из под ЛС (Мед. документация раздел 17).
  11. Контейнер для крепления пакета для отходов класса А.
  12. Контейнер для крепления пакета для отходов класса Б.
  13. Пакет для утилизации отходов класса А.
  14. Пакет для утилизации отходов класса Б.
  15. Непрокалываемый контейнер для утилизации отходов класса Б.
  16. Запасная игла Губера в штатной упаковке<sup>6</sup>.
  17. Контейнер для сбора мусора, образующегося на станции.
  18. Одноразовый шприц 20 мл.
  19. Инъекционная игла в стерильной упаковке.
  20. Нестерильные перчатки.
  21. Стерильные перчатки.
  22. Игла Губера в штатной стерильной упаковке.
  23. Стерильная упаковка для лотка.
  24. Ампулы с водой для инъекций 10 мл., имитирующие ампулы с NaCl, раствор 0,9%.
  25. Флакон с водой для инъекций 5 мл, имитирующий флакон с гепарином, раствор 5000 ед. в 1 мл (с наклейкой раздел 17).
  26. Спиртовые салфетки.
  27. Самоклеющаяся послеоперационная повязка.
  28. Самоклеющаяся повязка для фиксации катетеров.
  29. Водный маркер для записи на пластиковом кармане.
  30. Имплантируемая порт-система для химиотерапии.
  31. Имитатор крови.
  32. Дооснащённый имплантированной порт-системой фантом для катетеризации центральных вен.
- 

<sup>4</sup> В случае если раковиной оснастить рабочее место невозможно, аккредитуемым предлагается имитация средства для гигиенической обработки рук медицинского персонала

<sup>5</sup> В учебных целях все необходимые материалы сконцентрированы в одном месте, что не отражает реального условия хранения

<sup>6</sup> На стадии «Сбор материалов» предусмотрено наличие 2-х игл Губера, одна из которых предназначена для замены первой в случае поломки и пр., в связи с чем по условиям ситуации запасная игла не вскрывается и может быть использована многократно

**Дополнительное оборудование, которым можно оснастить станцию:**

- 33. Ножницы.
- 34. Дополнительные иглы.
- 35. Бикс с марлевыми шариками.
- 36. Нестерильный бинт.

**7.3. Расходные материалы** (из расчета на 1 попытку аккредитуемого)

- 1. Одноразовый шприц 20 мл – (2 шт.).
- 2. Инъекционная игла в стерильной упаковке (1 шт.).
- 3. Нестерильные перчатки (3 пары).
- 4. Стерильные перчатки (1 пара).
- 5. Игла Губера в штатной стерильной упаковке (1 шт.).
- 6. Стерильная упаковка для лотка (1 шт.).
- 7. Ампулы с водой для инъекций 10 мл., имитирующие ампулы с 0,9% раствором NaCl (3 шт.).
- 8. Флакон с водой для инъекций 5 мл, имитирующий флакон с раствором гепарина концентрации 5000 ед. в 1 мл. (1 шт. на 50 попыток).
- 9. Спиртовые салфетки (6 шт.).
- 10. Самоклеющаяся послеоперационная повязка типа Cosmopor E (1 шт.).
- 11. Самоклеющаяся повязка для фиксации катетеров типа Cosmopor I.V. (1 шт.).
- 12. Водный маркер для записи на пластиковом кармане (1 шт. на 50 попыток).
- 13. Тканевая салфетка 200\*200 мм для удаления записи маркером на пластиковом кармане (1 шт. на 50 попыток).
- 14. Пакет для утилизации отходов класса А (1 шт. на 50 попыток).
- 15. Пакет для утилизации отходов класса Б (1 шт. на 50 попыток).
- 16. Сменная кожа фантома для катетеризации центральных вен (1 шт. на 50 попыток).
- 17. Имплантируемая порт-система для химиотерапии (1 шт. на 50 попыток).
- 18. Имитатор крови (минимум 100 мл + 2 мл на каждую попытку).

**7.4. Симуляционное оборудование**

Фантом для катетеризации центральных вен с имплантированным подкожным портом (рис. 1). Место крепления порт-системы должно соответствовать наиболее распространённому месту установки порт-системы у среднестатистического пациента (II или III межреберье по среднеключичной линии). Катетер порт-системы с помощью гибкой силиконовой трубки необходимо герметично соединить с ёмкостью для имитатора крови. Ёмкость с имитатором крови закрепить на штативе рядом с фантомом на высоте 40-80 см от поверхности груди фантома. Комплектация фантома штатным набором сосудов для катетеризации центральных вен не требуется.

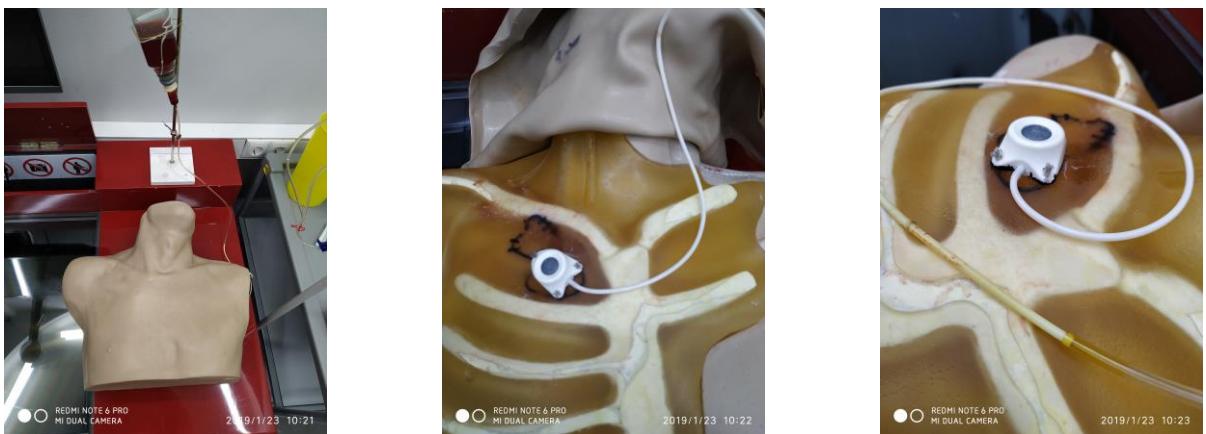


Рисунок 1. Схема модификации тренажера

## 8. Перечень ситуаций (сценариев) станции

Таблица 1

### Перечень ситуаций (сценариев) станции

№ п.п.	№ чек-листа	Ситуация
1	001	Соответствие листу назначения (п.17)
2	001	Соответствие листу назначения (п.17)

## 9. Информация (брифинг) для аккредитуемого

Вы врач онколог. В палате дневного стационара Вас ждёт пациент(ка) для проведения курса химиотерапии. Раствор лекарственных препаратов для введения подготовлен, премедикация выполнена.

Необходимо провести инфузию через имплантированный подкожный порт.

Все необходимые материалы для выполнения манипуляции находятся на станции. Пациент в сознании (используется модель), с ним можно общаться.

## 10. Информация для членов АК

### 10.1. Действия вспомогательного персонала перед началом работы станции

- Проверка соответствия оформления и комплектования станции ОСКЭ типовому паспорту с учетом количества аккредитуемых лиц.
- Проверка наличия на станции необходимых расходных материалов.
- Проверка наличия письменного задания (брифинга) перед входом на станцию.
- Проверка готовности симулятора к работе.
- Проверка готовности трансляции видеозаписей в комнату видеонаблюдения (при наличии таковой)..
- Проверка готовности оборудования с выходом в Интернет для работы в автоматизированной системе аккредитации специалистов.
- Выполнение иных мероприятий, необходимых для нормальной работы станции.

#### **10.2. Действия вспомогательного персонала в ходе работы станции**

1. Предоставление члену АК данных по пациенту (ФИО, возраст (год рождения). ФИО и возраст пациента должны соответствовать данным, указанным в табл. 2.
2. Включение видеокамеры при команде: «Прочтите задание...».
3. Контроль качества аудиовидеозаписи действий аккредитуемого (при необходимости).
4. Приведение станции после работы каждого аккредитуемого в первоначальный вид:
  - обновление листа амбулаторной карты пациента в пластиковом кармане (стереть запись, если она была произведена);
  - возвращение материала, который можно использовать многократно в исходный вид (вернуть лоток в стерильную упаковку);
  - удаление использованного материала (убрать мусор, снять повязку);
  - проверка наличия необходимых материалов для следующего аккредитуемого.

#### **10.3. Действия членов АК перед началом работы станции**

1. Проверка готовности станции к работе (наличие необходимых расходных материалов, письменного задания (брифинга), готовность симулятора к работе, наличие нужного сценария).
2. Получение логина и пароля для входа в автоматизированную систему аккредитации специалистов здравоохранения и вход в нее. Сверка своих персональных данных.
3. Выбор ситуации согласно решению АК.

#### **10.4. Действия членов АК в ходе работы станции**

1. Внесение индивидуального номера из логина, полученного перед прохождением первого этапа процедуры аккредитации в чек-лист в автоматизированной системе аккредитации специалистов здравоохранения.
2. Проведение регистрации последовательности и правильности действий/расхождения действий аккредитуемого в соответствии с параметрами в чек-листе.
3. Ведение минимально необходимого диалога с аккредитуемым от лица пациента и обеспечение дополнительными вводными для выполнения ситуации (сценария) (Табл. 2).

**Примечание:** Для членов АК с небольшим опытом работы на станции допускается увеличение промежутка времени для подготовки станции и заполнения чек-листа. Промежуток времени в таком случае должен быть равен периоду работы станции (10 минут).

Целесообразно использовать помощь вспомогательного персонала (сотрудников образовательной и или научной организации), обеспечивающего подготовку рабочего места в соответствии с оцениваемой ситуацией.

Таблица 2

**Текст дополнительных вводных**

<b>№ п/п</b>	<b>Действие аккредитуемого</b>	<b>Текст вводной</b>
1.	При обращении аккредитуемого к пациенту	Отвечать за пациента, в соответствии с документацией (раздел 17)
2.	При попытке аккредитуемого начать мыть руки	Дать вводную: «Будем считать, что руки обработаны»
3.	При сомнении аккредитуемым в стерильности и/или годности, целостности упаковки используемых инструментов и расходных материалов	Дать вводную: «Будем считать, что всё годно»
4.	При вопросе о самочувствии пациента во время процедуры	Ответить за пациента: «Нормально, спасибо доктор»
5.	После установки иглы Губера	Дать вводную: «Инфузационная система собрана и заполнена ЛС в соответствии с назначением»
6.	После подключения системы к установленной игле Губера	Дать вводную: «Инфузационная терапия закончена, необходимо снять иглу Губера»
7.	По окончании времени	Поблагодарить за работу и попросить перейти дальше

**Важно!** Нельзя говорить ничего от себя, вступать в переговоры, даже если Вы не согласны с мнением аккредитуемого. Не задавать уточняющих вопросов. Всё, что Вы бы хотели отметить, а этого нет в чек-листе, оформляйте в дефектной ведомости (раздел 13)

**11. Нормативные и методические документы, используемые для создания паспорта станции**

1. Приказ Минздрава России от 02.06.2016 N 334н «Об утверждении Положения об аккредитации специалистов»
2. Соответствующие приказы Минтруда России «Об утверждении профессионального стандарта» и/или его проекты
3. Правила обработки рук медицинского персонала и кожных покровов пациентов «Об утверждении САНПИН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»

4. СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами»
5. Письмо Роспотребнадзора №0100/4964-05-32 от 30.06.2005 «О системе сбора и утилизации медицинских отходов при иммунизации в лечебно-профилактических учреждениях Российской Федерации»
6. Комплект методических материалов по безопасности инъекций и сопутствующим процедурам ВОЗ. – 2011. 55 с. Режим доступа: [http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44298/4/9789244599259\\_rus.pdf?ua=1](http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44298/4/9789244599259_rus.pdf?ua=1)
7. Видео-пособие «Профилактика профессионального заражения инфекциями, передаваемыми с кровью». Открытый институт здоровья (<http://ohi.ru/>). Режим доступа: [https://www.youtube.com/watch?v=\\_ArSgNh1tYU](https://www.youtube.com/watch?v=_ArSgNh1tYU)
8. Прикладная флеботомия. Деннис Дж. Эрнст; [пер. с англ. Ф. С. Катасонов]. - Москва: Медиздат, 2014. - ХХ, 275 с.

### **11.1. Справочная информация**

1. Для успешного владения навыком необходима регулярная тренировка или практика, а также периодический контроль соблюдения всех правил.
2. Безопасная процедура — это процедура, которая не наносит вреда пациенту, не подвергает медработника какому-либо предотвратимому риску и не создает отходы, опасные для общества.
3. Во время проведения манипуляции необходимо обеспечить комфортное положение пациента и собственное положение. Предусмотреть отсутствие возможности падения пациента вследствие внезапной сосудистой недостаточности головного мозга (обморока). В подобной ситуации не рекомендовано использовать нашатырный спирт.
4. Все необходимые расходные материалы должны быть собраны и проверены на годность до начала проведения манипуляции
5. До и после манипуляции необходима гигиеническая обработка рук, которая в соответствии с СанПиН 2.1.3.2630-10 может проводиться двумя способами:
  - гигиеническое мытье рук мылом, содержащим антисептик, и водой;
  - или
  - обработка рук кожным антисептиком.Применение двух способов последовательно экономически нецелесообразно.
6. Манипуляция всегда проводится в перчатках. Нестерильные перчатки должны быть надеты перед возможностью воздействия небезопасной внешней среды (или сред пациента) на руки персонала (т.е. перед использованием антисептика для поливания марлевых шариков и/или вскрытия спиртовых салфеток). Более раннее использование перчаток повышает негативное воздействие на руки персонала самим фактором их ношения. Перчатки должны быть сняты как можно быстрее после исключения возможности контакта рук с небезопасной средой. Одна из задач всего алгоритма любой часто проводимой манипуляции – минимизировать время нахождения в перчатках до минимально необходимого. Стерильные

перчатки используются для поддержания стерильности используемых материалов, если это рекомендовано алгоритмами по данной манипуляции.

7. Целесообразно при обработке пункционного поля использовать движения от центра к периферии. Такой способ не предусматривает возвращения шарика с антисептиком на обработанную зону контаминированной поверхностью.

8. Надлежащая практика предписывает всегда предупреждать пациента перед введением иглы, даже если он без сознания. Наиболее подходящая для этого фраза: «Сейчас нужно будет потерпеть».

9. Места, где проводятся инъекции (пункции), должны быть снабжены аптечками «Анти-Вич» и укладками для оказания экстренной медицинской помощи.

10. Необходимо стремиться к минимизации количества и продолжительности эпизодов открывания бикса со стерильными изделиями медицинского назначения (далее – ИМН). В идеале этот вопрос решается специальными укладками с необходимым расходным материалом для конкретных манипуляций.

11. К сожалению, вопрос использования инструментов захвата (пинцетов, корнцангов) для работы со стерильными ИМН и расходными материалами урегулирован недостаточно и, тем не менее, является очень важным вопросом обеспечения работы медицинского персонала. После вскрытия упаковки стерильный пинцет может храниться на внутренней поверхности вскрытой упаковки. В случае накрытия стерильного стола, согласно п. 2.32 главы II СанПиН 2.1.3.2630-10, после вскрытия упаковки пинцет хранится в сухой стерильной емкости. На время работы в течение 6 часов необходимо иметь не менее 4 рабочих пинцетов, смена пинцета каждые 2 часа и 1 запасной. Хранение стерильного пинцета в емкости, наполненной стерильным раствором, санитарным правилами не предусмотрено и применяться не может.

**12. Информация для симулированного пациента**

Не предусмотрена

**13. Информация для симулированного коллеги**

Не предусмотрена

**14. Критерии оценивания действий аккредитуемого**

**В электронном чек-листе оценка правильности и последовательности выполнения действий аккредитуемым осуществляется с помощью активации кнопок**

- «Да» – действие было произведено;
- «Нет» – действие не было произведено

В случае демонстрации аккредитуемым невнесенных в пункты чек-листа важных действий или небезопасных и/или ненужных действий, необходимо зафиксировать эти

действия в дефектной ведомости (раздел 16) по данной станции, а в чек-лист внести только количество совершенных нерегламентированных и небезопасных действий.

Каждая позиция вносится членом АК в электронный чек-лист.

Для фиксации показателя времени необходимо активировать электронный чек-лист, как только аккредитуемый приступил к выполнению задания, а вносить показатель, как только аккредитуемый закончил выполнять действие.

**15. Дефектная ведомость**

<b>Станция Манипуляция (Проведение инфузионной терапии через подкожный порт) Образовательная организация _____</b>				
<b>№</b>	<b>Список нерегламентированных и небезопасных действий, отсутствующие в чек-листе</b>	<b>Номер аккредитуемого</b>	<b>Дата</b>	<b>Подпись члена АК</b>
<b>№</b>	<b>Список дополнительных действий, имеющих клиническое значение, не отмеченных в чек-листе</b>	<b>Номер аккредитуемого</b>	<b>Дата</b>	<b>Подпись члена АК</b>

Дополнительные замечания к организации станции в следующий эпизод аккредитации

---

---

---

---

ФИО члена АК

---

Подпись

**16. Оценочный лист (чек-лист)****16.1. Краткая версия чек-листа**

II этап аккредитационного экзамена Специальность \_\_\_\_\_  
 Дата \_\_\_\_\_ Номер кандидата \_\_\_\_\_  
**Номер ситуации** \_\_\_\_\_

<b>№</b>	<b>Действия аккредитуемого</b>	<b>Отметка о выполнении</b>
1.	Поздоровался с пациентом	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
2.	Идентифицировал себя	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
3.	Ознакомился с медицинской документацией	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
4.	Идентифицировал пациента	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
5.	Провел опрос и информировал пациента о процедуре	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
6.	Получил согласие пациента на процедуру	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
7.	Обработал руки бытовым способом перед началом процедуры	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
8.	Собрал всё необходимое для проведения процедуры	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
9.	Проверил годность собранных материалов	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
10.	Позиционировал пациента для проведения процедуры	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
11.	Надел первую пару нестерильных перчаток	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
12.	Осмотрел место над порт-системой, соблюдая правила асептики	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
13.	Утилизировал первую пару нестерильных перчаток	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
14.	Подготовил к использованию стерильный лоток	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
15.	Выложил в стерильный лоток самоклеющуюся повязку для фиксации катетеров	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
16.	Выложил в стерильный лоток первый шприц	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
17.	Выложил в стерильный лоток дополнительную иглу	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
18.	Выложил в стерильный лоток иглу Губера (далее – ИГ)	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
19.	Надел вторую пару нестерильных перчаток	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
20.	Вскрыл первую ампулу с NaCl, соблюдая правила асептики	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
21.	Вскрыл вторую ампулу с NaCl, соблюдая правила асептики	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
22.	Надел стерильные перчатки, соблюдая инструкцию на упаковке	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
23.	Набрал в первый шприц 20 мл NaCl, не нарушая стерильность	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
24.	Заполнил ИГ NaCl, не нарушая стерильность иглы	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
25.	Законсервировал первый шприц с остатком NaCl	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
26.	Обработал место пункции спиртовой салфеткой первый раз	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
27.	Повторно обработал место пункции спиртовой салфеткой	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
28.	Снял защитное устройство с ИГ	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
29.	Ввел ИГ в полость имплантированной порт-системы (далее – ИПС)	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
30.	Присоединил законсервированный шприц с NaCl к луэр-коннектору ИГ	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
31.	Выполнил контрольную тракцию до появления крови в луэр-коннекторе ИГ	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
32.	Промыл ИПС остатком NaCl в первом шприце	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет

33.	Утилизировал первый шприц и закрыть луэр-коннектор ИГ колпачком	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
34.	Зафиксировал ИГ на коже пациента самоклеющейся повязкой для фиксации катетеров	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
35.	Подключил инфузионную систему (далее – ИС) к луэр-коннектору ИГ	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
36.	Отрегулировал скорость инфузии	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
37.	Утилизировал образовавшиеся отходы в соответствующие ёмкости	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
38.	Обработал руки гигиеническим способом после подключения ИС	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
39.	Обработал руки гигиеническим способом перед извлечением ИГ	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
40.	Перекрыл ИС	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
41.	Надел третью пару нестерильных перчаток	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
42.	Удалил самоклеющуюся повязку для фиксации катетеров с руки пациента	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
43.	Подготовил флакон с гепарином, соблюдая правила асептики	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
44.	Вскрыл третью ампулу с NaCl, соблюдая правила асептики	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
45.	Подготовил второй шприц к набору гепарина, соблюдая правила асептики	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
46.	Набрал во второй шприц необходимое количество гепарина и NaCl	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
47.	Отсоединил ИС от луэр-коннектора ИГ	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
48.	Промыл ИПС гепариновым раствором и установить гепариновый замок	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
49.	Утилизировал второй шприц	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
50.	Извлек и утилизировал ИГ	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
51.	Наложил самоклеющуюся послеоперационную повязку на место пункции	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
52.	Обработал руки гигиеническим способом после манипуляции	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
53.	Сделал отметку в медицинской документации о выполнении манипуляции	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
54.	Не нарушил стерильность	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
55.	Мнение члена АК	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
56.	Благоприятное впечатление эксперта	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет

ФИО члена АК

подпись

Отметка о внесении в базу (ФИО)

## 16.2. Развёрнутая версия чек-листа

№	Действия аккредитуемого	Отметка о выполнении
1.	Ознакомление документацией	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
2.	Знакомство с пациентом	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
3.	Поздороваться с пациентом	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
4.	Представиться самому	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
5.	Попросить представиться пациента, узнав:	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
6.	: фамилию	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
7.	: имя	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
8.	: отчество	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
9.	: дата рождения	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
10.	Выяснить из медицинской документации:	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
11.	:Ф.И.О. пациента	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
12.	:дату рождения	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
13.	:название процедуры	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
14.	:наименование ЛС	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
15.	:объём	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
16.	:скорость введения	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
17.	Сверить полученную от пациента информацию с информацией в направлении	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
18.	Осведомиться о самочувствии пациента	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
19.	Сообщить о том, что пришли ввести л/с через подкожный порт.	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
20.	Выяснить у пациента:	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
21.	:были ли ранее проблемы с использованием порт-системы	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
22.	:о наличии у него аллергии на вводимое л/с	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
23.	:желает ли он узнать подробности процедуры	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
24.	Разъяснить пациенту суть предстоящей манипуляции:	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
25.	:если пациент выразил желание	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
26.	Спросить, согласен ли он на проведение процедуры	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
27.	Обработка рук	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
28.	Обработать руки:	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
29.	:бытовым способом	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
30.	Сбор материалов	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
31.	Первый стерильный шприц:	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
32.	: объёмом 20 мл	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
33.	Второй стерильный шприц:	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
34.	: объёмом 20 мл	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
35.	Дополнительную инъекционную иглу:	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
36.	:любого размера	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
37.	Первая пара нестерильных перчаток	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
38.	Вторая пара нестерильных перчаток	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
39.	Третья пара нестерильных перчаток	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
40.	Пару стерильных перчаток	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
41.	Первую иглу Губера	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
42.	Вторую иглу Губера	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет

№	Действия аккредитуемого	Отметка о выполнении
43.	Стерильный лоток	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
44.	Первую ампулу с раствором NaCl:	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
45.	:концентрацией 0,9%	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
46.	:объёмом 10 мл	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
47.	Вторую ампулу с раствором NaCl:	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
48.	:концентрацией 0,9%	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
49.	:объёмом 10 мл	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
50.	Третью ампулу с раствором NaCl:	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
51.	:концентрацией 0,9%	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
52.	:объёмом 10 мл	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
53.	Флакон с раствором гепарина:	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
54.	:объёмом 5 мл	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
55.	:концентрация 5000 ед в 1 мл	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
56.	Первую спиртовую салфетку	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
57.	Вторую спиртовую салфетку	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
58.	Третью спиртовую салфетку	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
59.	Четвёртую спиртовую салфетку	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
60.	Пятую спиртовую салфетку	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
61.	Шестую спиртовую салфетку	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
62.	Самоклеющуюся послеоперационную повязку	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
63.	Самоклеющуюся повязку для фиксации катетеров	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
64.	Закреплённый пакет для отходов класса А.	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
65.	Закреплённый пакет для отходов класса Б.	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
66.	Непрокалываемый контейнер для отходов класса Б	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
67.	Проверка годности материалов	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
68.	Проверить у шприцов:	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
69.	:срок годности	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
70.	:целостность	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
71.	:целостность упаковки	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
72.	:объём	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
73.	Проверить у дополнительной иглы:	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
74.	:срок годности	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
75.	:целостность	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
76.	:целостность упаковки	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
77.	Проверить у иглы Губера:	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
78.	:срок годности	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
79.	:целостность	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет

№	Действия аккредитуемого	Отметка о выполнении
80.	: целостность упаковки	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
81.	Проверить у самоклеющейся послеоперационной повязки	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
82.	: срок годности	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
83.	: целостность упаковки	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
84.	Проверить у самоклеющейся повязки для фиксации катетеров	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
85.	: срок годности	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
86.	: целостность упаковки	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
87.	Проверить у стерильных перчаток:	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
88.	: срок годности	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
89.	: целостность упаковки	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
90.	Проверить у ампул с NaCl:	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
91.	: срок годности	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
92.	: целостность	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
93.	: объём	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
94.	: концентрацию	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
95.	Проверить у флакона с гепарином:	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
96.	: срок годности	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
97.	: целостность	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
98.	: объём	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
99.	: концентрацию	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
100.	Проверить у спиртовых салфеток:	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
101.	: срок годности	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
102.	: целостность упаковки	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
103.	Позиционирование пациента	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
104.	Предложить пациенту раздеться до пояса	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
105.	Предложить пациенту лечь на кушетку:	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
106.	: на спину	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
107.	Обработка рук	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
108.	Обработать руки:	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
109.	: гигиеническим способом	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
110.	Осмотр места пункции	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
111.	Надеть первую пару нестерильных перчаток	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
112.	Провести осмотр кожи над порт-системой на наличие:	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
113.	: гиперемии	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
114.	Провести пальпацию кожи над порт-системой на наличие:	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
115.	: отёка	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
116.	: болезненности	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет

№	Действия аккредитуемого	Отметка о выполнении
117.	Снять первую пару нестерильных перчаток:	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
118.	:не касаясь наружной поверхности перчаток руками	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
119.	Утилизировать первую пару нестерильных перчаток:	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
120.	:закреплённый пакет для отходов класса Б.	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
121.	Подготовка стерильного лотка	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
122.	Взять стерильный лоток в упаковке	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
123.	Вскрыть стерильную упаковку лотка:	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
124.	:не касаясь лотка	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
125.	Выложить лоток на рабочую зону стола:	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
126.	:не касаясь лотка	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
127.	Утилизировать упаковку от лотка:	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
128.	:в закреплённый пакет для утилизации отходов класса А	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
129.	Распаковка самоклеющейся повязки для фиксации катетеров	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
130.	Взять самоклеющуюся повязку для фиксации катетеров	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
131.	Вскрыть упаковку самоклеющейся повязки для фиксации катетеров	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
132.	:не касаясь пластиря	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
133.	Выложить самоклеющуюся повязку для фиксации катетеров	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
134.	:в стерильный лоток	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
135.	:не касаясь пластиря	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
136.	Утилизировать упаковку от пластиря:	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
137.	:в закреплённый пакет для утилизации отходов класса А	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
138.	Распаковка первого шприца	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
139.	Взять первый шприц в стерильной упаковке	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
140.	Вскрыть упаковку шприца:	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
141.	:не касаясь шприца	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
142.	Выложить шприц с иглой:	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
143.	:в стерильный лоток	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
144.	:не соединяя шприца с иглой	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
145.	:не касаясь шприца	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
146.	:не касаясь иглы	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
147.	Утилизировать упаковку от шприца:	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
148.	:в закреплённый пакет для утилизации отходов класса А	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
149.	Распаковка дополнительной иглы	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
150.	Взять дополнительную иглу в стерильной упаковке	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
151.	Вскрыть упаковку иглы:	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
152.	:не касаясь иглы	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
153.	Выложить иглу:	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет

№	Действия аккредитуемого	Отметка о выполнении
154.	:в стерильный лоток	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
155.	:не касаясь иглы	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
156.	:не снимая колпачка с иглы	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
157.	Утилизировать упаковку от иглы:	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
158.	:в закреплённый пакет для утилизации отходов класса А	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
159.	Распаковка иглы Губера	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
160.	Взять иглу Губера в стерильной упаковке	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
161.	Вскрыть упаковку иглы Губера:	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
162.	:не касаясь иглы Губера	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
163.	Выложить иглу Губера:	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
164.	:в стерильный лоток	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
165.	:не касаясь иглы	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
166.	Утилизировать упаковку от иглы Губера:	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
167.	:в закреплённый пакет для утилизации отходов класса А	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
168.	Вскрытие первой ампулы NaCl	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
169.	Надеть вторую пару нестерильных перчаток	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
170.	Взять первую спиртовую салфетку в стерильной упаковке	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
171.	Вскрыть упаковку салфетки	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
172.	Извлечь салфетку из упаковки	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
173.	Утилизировать упаковку от салфетки:	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
174.	:в закреплённый пакет для утилизации отходов класса А	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
175.	:удерживая саму салфетку доминантной рукой	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
176.	Взять первую ампулу с раствором NaCl:	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
177.	:недоминантной рукой	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
178.	Обработать шейку ампулы спиртовой салфеткой	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
179.	Вскрыть ампулу:	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
180.	:обернув шейку салфеткой	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
181.	:одним движением	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
182.	:с первой попытки	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
183.	:расходящимися краями надлома от себя	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
184.	Утилизировать головку ампулы:	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
185.	:непрокалываемый контейнер для отходов класса Б	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
186.	:вместе с первой спиртовой салфеткой	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
187.	Поставить вскрытую первую ампулу на стол рядом с лотком	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
188.	Вскрытие второй ампулы NaCl	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
189.	Взять вторую спиртовую салфетку в стерильной упаковке	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
190.	Вскрыть упаковку салфетки	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет

№	Действия аккредитуемого	Отметка о выполнении
191.	Извлечь салфетку из упаковки	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
192.	Утилизировать упаковку от салфетки:	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
193.	:в закреплённый пакет для утилизации отходов класса А	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
194.	:удерживая саму салфетку доминантной рукой	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
195.	Взять вторую ампулу с раствором NaCl:	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
196.	:недоминантной рукой	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
197.	Обработать шейку ампулы спиртовой салфеткой	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
198.	Вскрыть ампулу:	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
199.	:обернув шейку салфеткой	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
200.	:одним движением	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
201.	:с первой попытки	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
202.	:расходящимися краями надлома от себя	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
203.	Утилизировать головку ампулы:	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
204.	:непрокалываемый контейнер для отходов класса Б	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
205.	:вместе со второй спиртовой салфеткой	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
206.	Поставить вскрытую вторую ампулу на стол рядом с лотком	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
207.	Надевание стерильных перчаток	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
208.	Снять нестерильные перчатки	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
209.	Утилизировать снятые перчатки:	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
210.	:в закреплённый пакет для утилизации отходов класса А	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
211.	Взять стерильные перчатки в стерильной упаковке	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
212.	Вскрыть упаковку:	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
213.	:как это показано на упаковке	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
214.	Положить вскрытую упаковку на стол:	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
215.	:в стороне от лотка	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
216.	:перед собой	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
217.	:не извлекая перчаток из упаковки	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
218.	Надеть стерильные перчатки:	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
219.	:следуя инструкциям на упаковке	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
220.	:не прикасаясь ничем к наружной поверхности перчаток	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
221.	:оставить упаковку от перчаток на месте	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
222.	Набор NaCl в первый шприц	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
223.	Взять первый шприц из лотка:	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
224.	:одной рукой	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
225.	Взять первую иглу из лотка:	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
226.	:второй рукой	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
227.	Присоединить первую иглу к канюле первого шприца	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет

<b>№</b>	<b>Действия аккредитуемого</b>	<b>Отметка о выполнении</b>
228.	Снять колпачок с иглы:	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
229.	:фиксируя канюлю иглы пальцем	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
230.	Утилизировать снятый колпачок:	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
231.	:в закреплённый пакет для утилизации отходов класса А	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
232.	Набрать в первый шприц раствор NaCl:	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
233.	:20 мл	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
234.	:из первой и второй ампул стоящих на столе	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
235.	:не касаясь самих ампул стерильными перчатками	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
236.	Оставить пустые ампулы на их прежнем месте	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
237.	Отсоединить иглу от шприца с раствором NaCl	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
238.	Утилизировать отсоединенную иглу:	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
239.	:непрокалываемый контейнер для отходов класса Б	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
240.	Положить шприц с раствором NaCl:	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
241.	:в стерильный лоток	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
242.	Заполнение иглы Губера	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
243.	Взять луэр-коннектор иглы Губера:	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
244.	:из стерильного лотка	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
245.	:одной рукой	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
246.	Открутить колпачок с луэр-коннектора иглы Губера:	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
247.	:второй рукой	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
248.	Положить колпачок в стерильный лоток:	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
249.	:удерживая коннектор первой рукой	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
250.	Взять шприц с раствором NaCl:	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
251.	:второй рукой	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
252.	Присоединить шприц с раствором NaCl к луэр-коннектору	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
253.	Заполнить систему иглы Губера раствором NaCl из шприца:	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
254.	:до появления капли раствора на конце иглы Губера	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
255.	Отсоединить шприц с остатком раствора NaCl от луэр-коннектора иглы Губера	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
256.	Положить шприц с остатком раствора NaCl:	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
257.	:в стерильный лоток	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
258.	:удерживая коннектор иглы Губера другой рукой	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
259.	Взять колпачок луэр-коннектора иглы Губера:	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
260.	: из стерильного лотка	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
261.	Навинтить колпачок на луэр-коннектор иглы Губера	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
262.	Положить закрытый луэр-коннектор:	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
263.	:в стерильный лоток	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет

№	Действия аккредитуемого	Отметка о выполнении
264.	Консервация шприца с NaCl	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
265.	Взять шприц с остатком раствора NaCl:	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
266.	: одной рукой	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
267.	Взять дополнительную иглу:	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
268.	: второй рукой	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
269.	Присоединить иглу к шприцу:	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
270.	:не снимая колпачка с иглы	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
271.	Положить собранный шприц в стерильный лоток	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
272.	Первая обработка места пункции	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
273.	Взять третью спиртовую салфетку в стерильной упаковке	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
274.	Вскрыть упаковку салфетки	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
275.	Извлечь салфетку из упаковки	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
276.	Утилизировать упаковку от третьей салфетки:	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
277.	:в закреплённый пакет для утилизации отходов класса А	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
278.	Обработать область вокруг порта:	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
279.	:третьей спиртовой салфеткой	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
280.	:круговыми движениями	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
281.	:от центра к периферии	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
282.	Утилизировать третью салфетку:	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
283.	:в закреплённый пакет для утилизации отходов класса Б	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
284.	Вторая обработка места пункции	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
285.	Взять четвёртую спиртовую салфетку в стерильной упаковке	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
286.	Вскрыть упаковку салфетки	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
287.	Извлечь салфетку из упаковки	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
288.	Утилизировать упаковку от четвёртой салфетки:	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
289.	:в закреплённый пакет для утилизации отходов класса А	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
290.	Обработать повторно область вокруг порта:	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
291.	:четвёртой спиртовой салфеткой	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
292.	:круговыми движениями	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
293.	:от центра к периферии	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
294.	Утилизировать четвёртую салфетку:	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
295.	:в закреплённый пакет для утилизации отходов класса Б	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
296.	Пункция	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
297.	Взять иглу Губера	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
298.	:за круглое основание	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
299.	:доминантной рукой	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
300.	Снять защитное устройство с колющей части иглы Губера:	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет

<b>№</b>	<b>Действия аккредитуемого</b>	<b>Отметка о выполнении</b>
301.	:недоминантной рукой	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
302.	Утилизировать защитное устройство:	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
303.	:в закреплённый пакет для утилизации отходов класса А	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
304.	Придержите подкожный порт:	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
305.	:двумя пальцами	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
306.	:недоминантной руки	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
307.	:чтобы между пальцами могло пройти круглое основание иглы Губера	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
308.	Введите иглу Губера в центр подкожного порта:	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
309.	:удерживая за круглое основание	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
310.	:перпендикулярно мемbrane порта	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
311.	:до касания иглой дна камеры порта	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
312.	Контрольная тракция	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
313.	Возьмите шприц с остатком раствора NaCl:	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
314.	:доминантной рукой	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
315.	Отсоединить иглу от шприца:	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
316.	:недоминантной рукой	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
317.	:не снимая колпачка	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
318.	Утилизировать иглу в колпачке:	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
319.	:непрокалываемый контейнер для отходов класса Б	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
320.	Взять за основание луэр-коннектора:	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
321.	:недоминантной руки	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
322.	Отвинтить колпачок с луэр-коннектора:	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
323.	:доминантной рукой	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
324.	:одновременно удерживая ею шприц	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
325.	Положить колпачок луэр-коннектора в стерильный лоток	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
326.	Присоединить шприц с остатком раствора NaCl к луэр-коннектору	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
327.	Выполнить тракцию поршнем шприца на себя:	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
328.	:убедиться что в луэр-коннекторе появилась кровь	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
329.	Промывание ИПС	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
330.	Ввести остатки раствора NaCl:	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
331.	:тракцией поршня от себя	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
332.	:медленно	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
333.	:переодическиправляясь о самочувствии пациента	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
334.	:при отсутствии отёка в области порта	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
335.	:доведя поршень шприца до упора	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
336.	Отсоединить шприц от луэр-коннектора:	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
337.	: доминантной рукой	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет

№	Действия аккредитуемого	Отметка о выполнении
338.	:удерживая основание луэр-коннектора недоминантной рукой	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
339.	Утилизировать шприц:	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
340.	:в закреплённый пакет для утилизации отходов класса Б	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
341.	:удерживая основание луэр-коннектора недоминантной рукой	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
342.	Взять колпачок луэр-коннектора из стерильного лотка:	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
343.	:доминантной рукой	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
344.	Накрутить колпачок на луэр-коннектор:	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
345.	:доминантной рукой	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
346.	:удерживая основание луэр-коннектора недоминантной рукой	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
347.	Наложение самоклеющейся повязки для фиксации катетеров	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
348.	Взять из лотка самоклеющуюся повязку для фиксации катетеров	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
349.	Закрепить иглу Губера на коже пациента:	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
350.	:пластырем	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
351.	:поверх основания иглы Губера	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
352.	Утилизировать защитную плёнку пластиря:	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
353.	:в закреплённый пакет для утилизации отходов класса А	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
354.	Сборка системы	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
355.	Подключение системы	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
356.	Открутить колпачок с луэр-коннектора:	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
357.	:доминантной рукой	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
358.	:удерживая основание луэр-коннектора недоминантной рукой	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
359.	Утилизировать колпачок:	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
360.	:в закреплённый пакет для утилизации отходов класса Б	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
361.	Взять заполненную инфузционную систему:	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
362.	:доминантной рукой	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
363.	:за основание канюли	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
364.	Отсоединить от канюли иглу в колпачке или иное защитное устройство:	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
365.	:недоминантной рукой	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
366.	Утилизировать защитное устройство:	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
367.	:непрокалываемый контейнер для отходов класса Б	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
368.	Присоединить канюлю инфузационной системы к луэр-коннектору:	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
369.	:доминантной рукой	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
370.	:удерживая основание луэр-коннектора недоминантной рукой	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
371.	Отрегулировать необходимую скорость инфузии	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
372.	Утилизация отходов	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
373.	Утилизировать пустые ампулы	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
374.	:непрокалываемый контейнер для отходов класса Б	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет

№	Действия аккредитуемого	Отметка о выполнении
375.	Утилизировать упаковку от стерильных перчаток:	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
376.	:в закреплённый пакет для утилизации отходов класса А	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
377.	Снять стерильные перчатки:	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
378.	:не касаясь наружной поверхности перчаток руками	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
379.	Утилизировать снятые перчатки:	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
380.	:в закреплённый пакет для утилизации отходов класса Б	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
381.	Отправить лоток на стерилизацию	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
382.	Обработать руки:	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
383.	:гигиеническим способом	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
384.	Инфузационная терапия	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
385.	Завершение инфузционной терапии	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
386.	Обработать руки:	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
387.	:гигиеническим способом	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
388.	Перекрыть запирающее устройство инфузационной системы	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
389.	Надеть третью пару нестерильных перчаток	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
390.	Удалить самоклеющуюся повязку для фиксации катетеров с руки пациента	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
391.	Утилизировать пластырь самоклеющуюся повязку для фиксации катетеров	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
392.	:в закреплённый пакет для утилизации отходов класса Б	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
393.	Подготовка флакона с гепарином	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
394.	Взять пятую спиртовую салфетку в стерильной упаковке	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
395.	Вскрыть упаковку салфетки	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
396.	Извлечь салфетку из упаковки	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
397.	Утилизировать упаковку от четвёртой салфетки:	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
398.	:в закреплённый пакет для утилизации отходов класса А	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
399.	:удерживая саму салфетку доминантной рукой	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
400.	Взять флакон с гепарином	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
401.	Обработать прокалываемую пробку флакона с гепарином:	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
402.	:пятой спиртовой салфеткой	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
403.	Утилизировать пятую салфетку:	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
404.	:в закреплённый пакет для утилизации отходов класса А	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
405.	Поставить флакон с гепарином на рабочую зону стола	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
406.	Вскрытие третьей ампулы NaCl	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
407.	Взять шестую спиртовую салфетку в стерильной упаковке	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
408.	Вскрыть упаковку салфетки	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
409.	Извлечь салфетку из упаковки	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
410.	Утилизировать упаковку от салфетки:	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
411.	:в закреплённый пакет для утилизации отходов класса А	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет

№	Действия аккредитуемого	Отметка о выполнении
412.	:удерживая саму салфетку доминантной рукой	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
413.	Взять третью ампулу с раствором NaCl:	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
414.	:недоминантной рукой	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
415.	Обработать шейку ампулы спиртовой салфеткой	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
416.	Вскрыть ампулу:	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
417.	:обернув шейку салфеткой	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
418.	:одним движением	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
419.	:с первой попытки	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
420.	:расходящимися краями надлома от себя	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
421.	Утилизировать головку ампулы:	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
422.	:в непротакливаемый контейнер для отходов класса Б	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
423.	:вместе с шестой спиртовой салфеткой	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
424.	Поставить вскрытую третью ампулу с раствором NaCl на рабочую зону стола	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
425.	Распаковка второго шприца	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
426.	Взять второй шприц	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
427.	Вскрыть стерильную упаковку шприца:	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
428.	:со стороны поршня	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
429.	Удерживая шприц одной рукой через упаковку	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
430.	Второй рукой взяться за ручку поршня	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
431.	Обеспечить соединение цилиндра с иглой внутри упаковки	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
432.	Извлечь собранный шприц из упаковки	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
433.	Утилизировать упаковку от шприца:	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
434.	:в закреплённый пакет для утилизации отходов класса А	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
435.	Снять колпачок с иглы:	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
436.	:удерживая канюлю иглы большим и указательным пальцами	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
437.	Утилизировать колпачок:	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
438.	:в закреплённый пакет для утилизации отходов класса А	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
439.	Набор гепарина	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
440.	Проколоть иглой шприца резиновую пробку флакона с гепарином:	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
441.	:флакон стоит на столе	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
442.	:свободная рука не касается флакона	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
443.	Набрать в шприц гепарин:	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
444.	:0,1 мл (внутренний объём наконечника-конуса шприца)	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
445.	Извлечь иглу из флакона с гепарином:	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
446.	:не отсоединяя её от шприца	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
447.	:фиксируя одним пальцем канюлю иглы	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет

№	Действия аккредитуемого	Отметка о выполнении
448.	Набор NaCl в первый шприц	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
449.	Погрузить иглу шприца в ампулу с раствором NaCl:	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
450.	:ампула стоит на столе	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
451.	:свободная рука не касается ампулы в момент погружения иглы	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
452.	Набрать в шприц раствор NaCl:	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
453.	:10 мл	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
454.	Утилизировать пустую ампулу:	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
455.	:в непрокалываемый контейнер для отходов класса Б	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
456.	Отсоединить иглу от шприца	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
457.	Утилизировать иглу:	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
458.	:в непрокалываемый контейнер для отходов класса Б	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
459.	Установка гепаринового замка	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
460.	Отсоединить канюлю инфузионной системы от луэр-коннектора:	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
461.	:доминантной рукой	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
462.	:удерживающей шприц с раствором NaCl	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
463.	:фиксируя основание луэр-коннектора недоминантной рукой	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
464.	Повесить гибкую трубку инфузионной системы на держатель штатива	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
465.	Присоединить шприц с гепариновым раствором к луэр-коннектору	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
466.	Промыть порт-систему гепариновым раствором:	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
467.	:выполнив тракцию поршнем от себя	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
468.	Перекрыть запирающее устройство гибкого проводника порт-системы:	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
469.	:продолжая выполнять тракцию поршнем от себя	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
470.	Отсоединить шприц от луэр-коннектора:	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
471.	:придерживая луэр-коннектор за основание	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
472.	Утилизировать шприц:	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
473.	:в закреплённый пакет для утилизации отходов класса Б	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
474.	Извлечение иглы Губера	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
475.	Извлечь иглу Губера с проводником из порт-системы	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
476.	Утилизировать иглу Губера с проводником:	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
477.	:в непрокалываемый контейнер для отходов класса Б	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
478.	Наложение послеоперационной повязки	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
479.	Взять пластырь послеоперационной повязки	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
480.	Вскрыть упаковку пластыря послеоперационной повязки	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
481.	Извлечь пластырь послеоперационной повязки	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
482.	Утилизировать упаковку от пластыря:	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
483.	:в закреплённый пакет для утилизации отходов класса А	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
484.	Наклеить послеоперационную повязку на место пункции	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет

<b>№</b>	<b>Действия аккредитуемого</b>	<b>Отметка о выполнении</b>
485.	Утилизировать защитную плёнку пластиря:	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
486.	:в закреплённый пакет для утилизации отходов класса А	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
487.	Завершение процедуры	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
488.	Снять нестерильные перчатки:	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
489.	:не касаясь наружной поверхности перчаток руками	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
490.	Утилизировать снятые перчатки:	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
491.	:в закреплённый пакет для утилизации отходов класса Б	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
492.	Обработать руки:	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
493.	:гигиеническим способом	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
494.	Сделать отметку о выполненной манипуляции в медицинской документации	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
495.	Благоприятное впечатление эксперта	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет


---

ФИО члена АК

подпись

Отметка о внесении в базу (ФИО)

## **17. Медицинская документация**

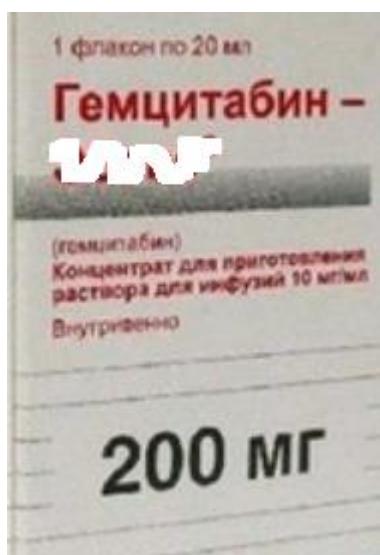

и/б 31998/2019

OMC

Лист назначений

ФИО пациента: \_\_\_\_\_

Возраст: \_\_\_\_\_

Диагноз: XXXXXX

Лечащий врач:  (Арбузов А.А.)

Дата назначений: XX.XX.XXXX

Наименование	Кол-во раз	Дозировка	Способ введения	Режим	Время	Выполнено
Кларитин 10 мг	1	10 мг	Перорально	-	xx:xx: - 1	
Натрия хлорид 0,9% 400,0 №1	1	400 мл	Через порт	1 час	xx:xx: - 2	
Гемцитабин 10 мг/мл 20 №10	1	2000 мг	Через порт		xx:xx: - 2	